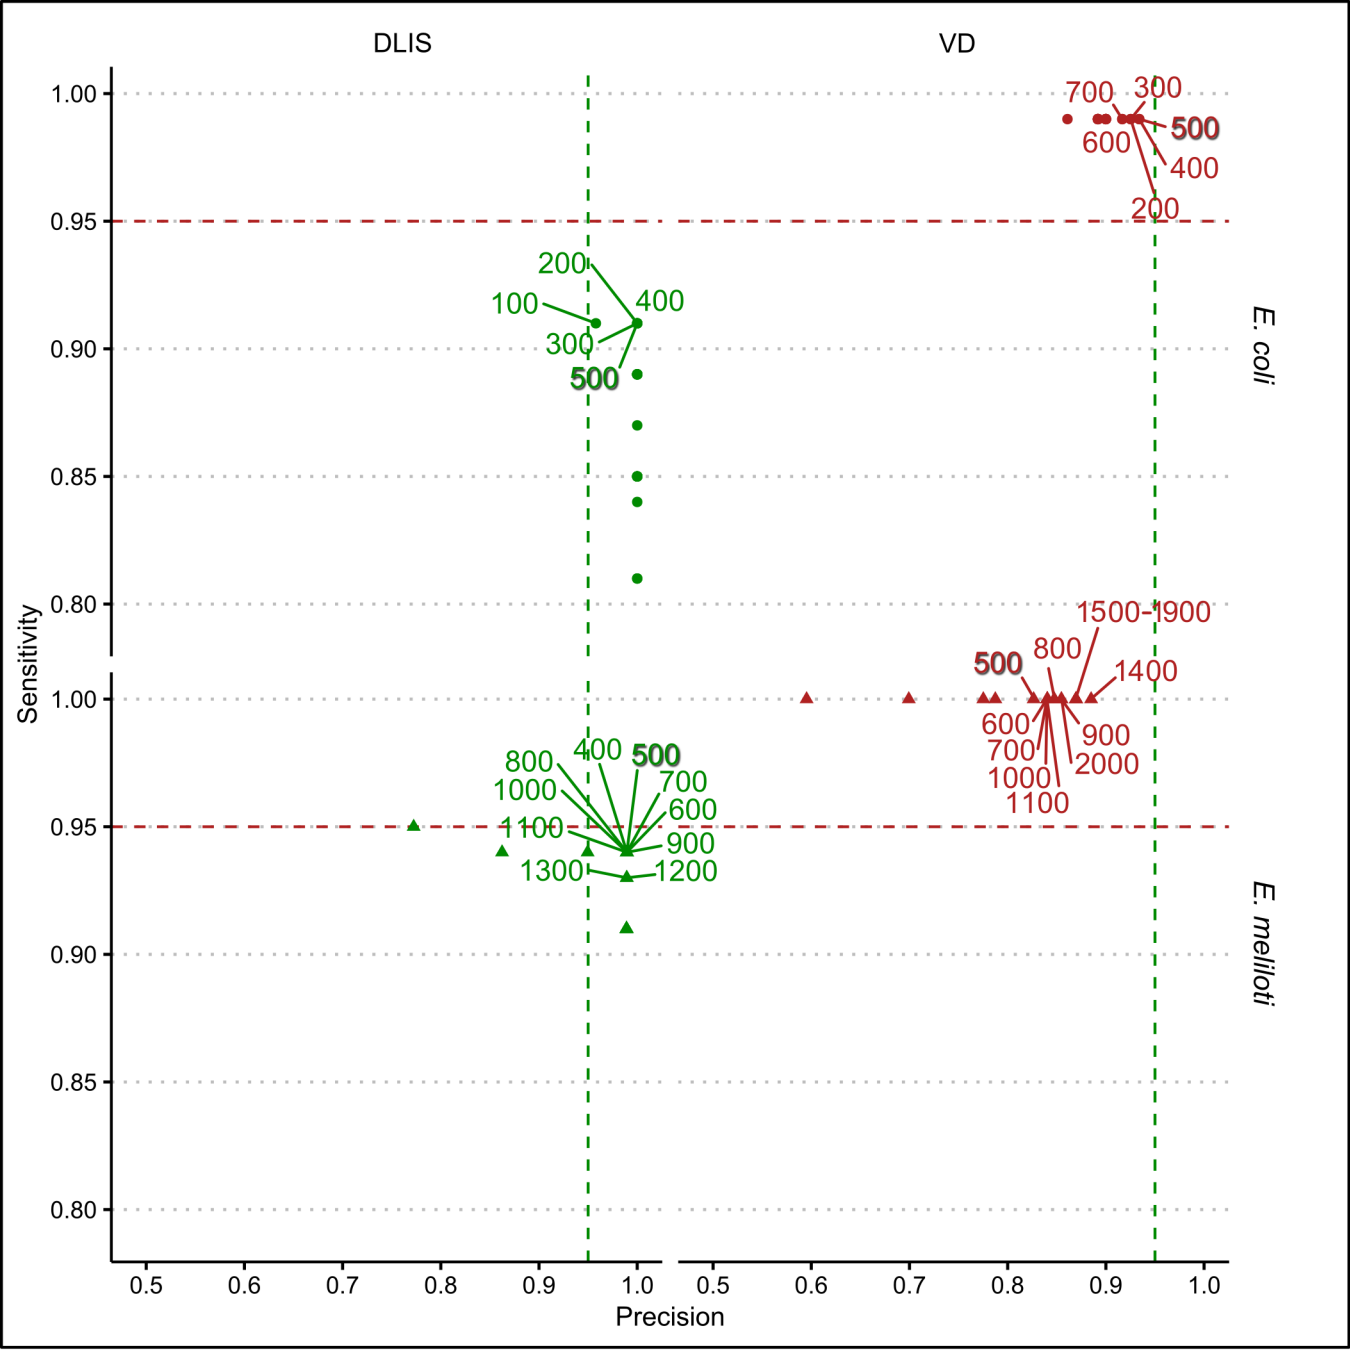
DLIS
VD
E. coli
E. meliloti
Sensitivity
Precision
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
700
300
500
600
400
200
200
100
400
300
500
1500-1900
500
800
1400
600
900
700
2000
1000
1100
800
400
500
700
1000
600
1100
900
1300
1200